

Số 127 /TM-BVPN

Đức Linh, ngày 12 tháng 9 năm 2024

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Căn cứ Quyết định số 332/QĐ-BVPN ngày 12/9/2024 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm gói thầu số 5: Bảo trì định kỳ máy gây mê kèm thở năm 2024.

Nay, Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam, có nhu cầu tiếp nhận báo giá để làm cơ sở xét chọn giá gói thầu và lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5: Bảo trì định kỳ máy gây mê kèm thở năm 2024, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam

- Địa chỉ: Xã Nam Chính, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

- Điện thoại: 02523. 883 033

- Đại diện là Ông: Lê Văn Huỳnh

Chức vụ: Giám đốc

2. Thông tin gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 5: Bảo trì định kỳ máy gây mê kèm thở năm 2024,

3. Hình thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại: (Văn thư phòng TC HC) của Bệnh viện hoặc gửi qua email của bệnh viện: bvdkkvnbt@syt.binhthuan.gov.vn

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 12 tháng 9 năm 2024 đến trước 17h ngày 23/9/2024, (Báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét).

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 23/9/2024.

6. Nội dung báo giá: Bảo trì định kỳ máy gây mê kèm thở năm 2024 (thời gian thực hiện 12 tháng), nội dung thực hiện gói thầu trong bảng dưới đây:


| STT | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ(*) | Khối lượng | Số lượng, đơn vị tính | Địa điểm thực hiện dịch vụ | Dự kiến ngày hoàn thành thành dịch vụ |
|-----|--|--|---|-----------------------|---|---------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Máy gây mê kèm thở: - Model: Fabius Plus - Seri: ASHK - 0083 - Hãng sản xuất: Dragerwerk | Bảo trì định kỳ 3 tháng 1 lần (04 lần/năm) | 1. Kiểm tra chung toàn bộ hệ thống máy gây mê kèm thở. 2. Kiểm tra chung toàn bộ hệ thống mạch thở. 3. Kiểm tra phần điều khiển. 4. Kiểm tra nguồn khí. 5. Kiểm tra hệ thống thải khí mê (nếu có) 6. Kiểm tra hệ bình bóc hơi 7. Kiểm tra van an toàn và bộ | 01 Máy | Khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện ĐKKV phía Nam | |

| | | | | | |
|---|--|--|---|--------|--|
| | - Nước sản xuất: Đức | | chỉnh lưu lượng 8. Run System test (SYSTEM DIAGNOSTICS) 9. Calibrate Flow sensor 10. Calibrate O2 Sensor 11. Leak/ Compl Test 12. Safety Relief Vavel Test 13. Kiểm tra lại toàn bộ chức năng hoạt động của máy. 14. Thay một số vật tư cho máy như bộ kit. | | |
| 2 | Máy gây mê kèm thở: - Model: Astra 3i - Seri: 22006-112 - Hãng sản xuất: OES Medical - Nước sản xuất: Anh | Bảo trì định kỳ 3 tháng 1 lần (04 lần/năm) | 1. Kiểm tra chung toàn bộ hệ thống Máy gây mê kèm thở. 2. Kiểm tra chung toàn bộ hệ thống mạch thở. 3. Kiểm tra phần điều khiển. 4. Kiểm tra nguồn khí. 5. Kiểm tra hệ thống thải khí mê (nếu có) 6. Kiểm tra hệ bình bốc hơi 7. Kiểm tra van an toàn và bộ chỉnh lưu lượng 8. Run System test (SYSTEM DIAGNOSTICS) 9. Calibrate Flow sensor 10. Calibrate O2 Sensor 11. Leak/ Compl Test 12. Safety Relief Vavel Test. 13. Kiểm tra lại toàn bộ chức năng hoạt động của máy. 14. Thay một số vật tư cho máy như bộ kit. | 01 Máy | Khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện ĐKKV phía Nam |

Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam, kính mời các đơn vị, các công ty (Nhà thầu cung cấp) quan tâm cho báo giá gói thầu nêu trên./.
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

Như trên;
Tổ CNTT BV đăng tải,
Lưu VT, VT-TBYT.

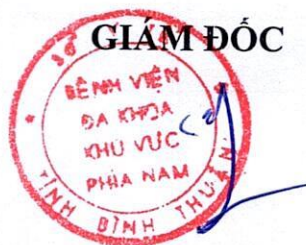

Lê Văn Huỳnh